


THERMAREST[®]

COMPACK™ CHAIR

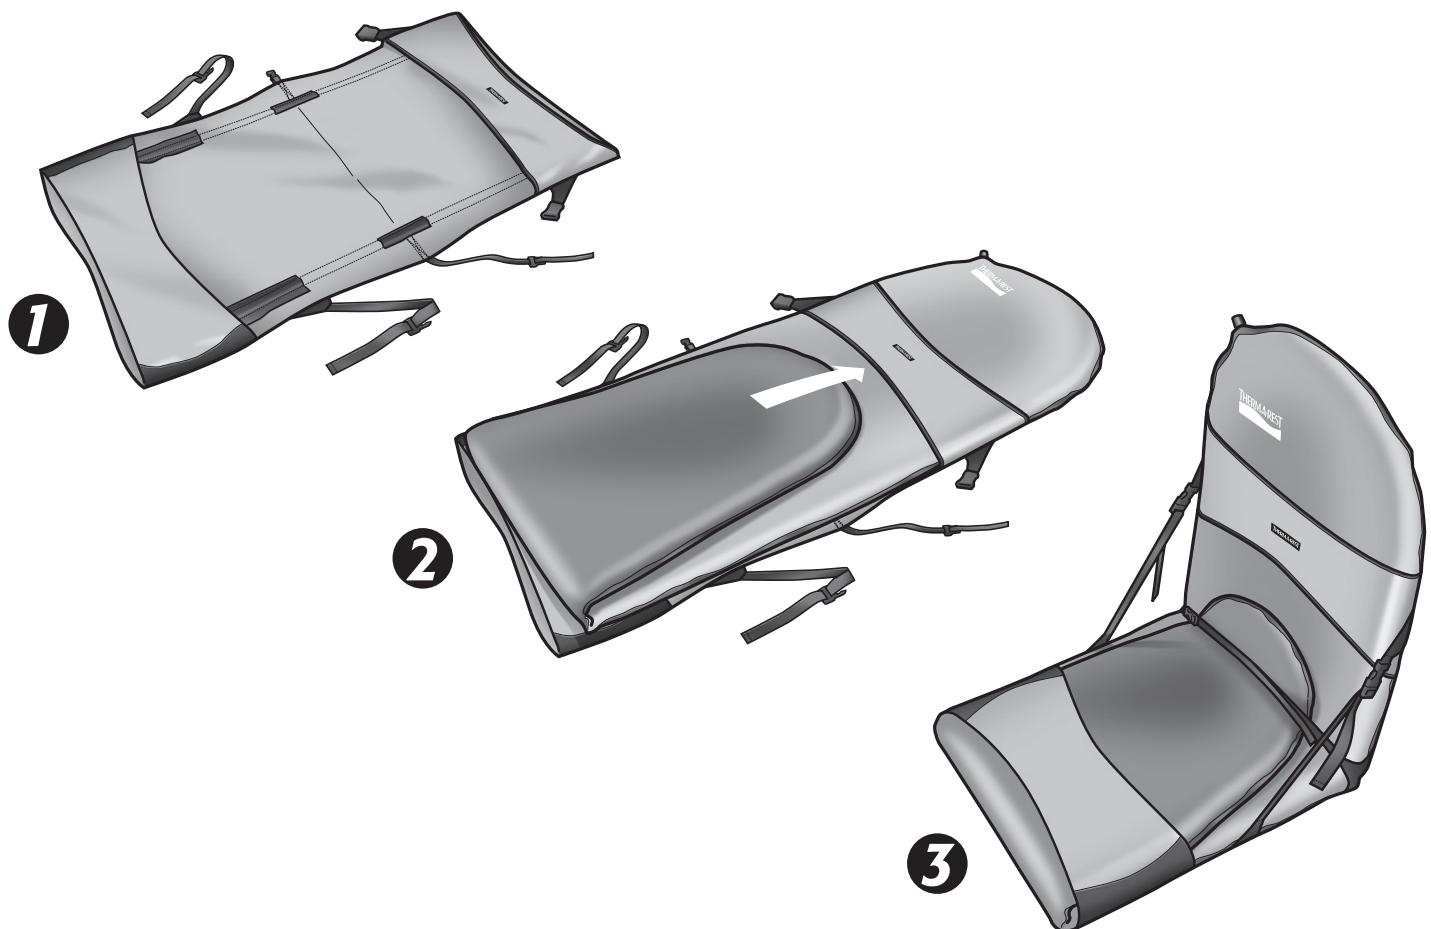

Assembly Instructions:

- 1 Unbuckle side straps. Lay chair flat on the ground, pockets facing up.
- 2 Open valve to partially inflate your mattress. Close valve. Insert valve end into chair sleeve. Fold end of mattress to fit in bottom pocket. Adjust fold according to length of mattress. Fasten center strap and buckle across mattress to keep it secure.
- 3 Tighten side straps to bring top pocket of chair sleeve to an upright position. Sit in chair and adjust side straps for comfort and support. Adjust air pressure, if necessary.

Anleitung:

- 1 Schnallen Sie die Seitenriemen los. Legen Sie den Stuhl flach auf den Boden mit den Taschen nach oben.
- 2 Öffnen Sie das Ventil, um Ihre Matte teilweise aufzublasen. Schließen Sie das Ventil. Drücken Sie das Ventilende in die Stuhldecke. Falten Sie das Ende der Matte so, dass es in die untere Tasche passt. Falten Sie entsprechend der Mattenlänge. Schnallen Sie den mittleren Riemen quer über der Matte fest.
- 3 Ziehen Sie die Seitenriemen fest, um die obere Tasche der Stuhldecke in aufrechte Position zu bringen. Setzen Sie sich in den Stuhl, und erhöhen Sie den Komfort und die Stützwirkung durch Anpassen der Seitenriemen. Passen Sie, wenn nötig, den Luftdruck an.

Instructions de montage :

- 1 Détailler les sangles latérales. Déposer la chaise à plat sur le sol, les poches vers le haut.
- 2 Ouvrir la valve pour gonfler partiellement le matelas. Fermer la valve. Insérer l'extrémité valve du matelas dans la poche supérieure de la chaise. Replier l'autre extrémité du matelas pour l'insérer dans la poche inférieure. Ajuster le pli en fonction de la longueur du matelas. Régler la sangle centrale et la boucler autour du matelas pour immobiliser celui-ci.
- 3 Serrer les sangles latérales de façon à relever la section supérieure de la chaise. S'asseoir dans la chaise et régler les sangles latérales de façon à obtenir un soutien confortable. Si nécessaire, régler la pression d'air.

組立手順:

- 1 サイドストラップのバックルをはずします。ポケットが上向きになるように、イスを平らにして地面の上に置きます。
- 2 バルブを開いて、マットレスを少し膨らませます。バルブを閉じます。バルブの端をチエアスリーブの中に挿入します。マットレスの端を折りたたみ、下部のポケットに入れ込みます。マットレスの長さによって、折り曲げ具合を調整します。中央のストラップとバックルをマットレスに巻いて、しっかりと締めます。
- 3 チエアスリーブ上部にあるポケットが直立するように、サイドストラップをしっかりと締めます。イスに座って、快適なサポートが得られるようにサイドストラップを調節します。必要であれば、空気圧を調整します。